



Pecuária Sudeste

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA PARA LABORATÓRIOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL

EPLNA – ANO 9 – 2006

RELATÓRIO DO PRIMEIRO LOTE

INTRODUÇÃO

De acordo com padrões internacionais da ISO/IEC 17025 (2001), laboratórios devem implementar e manter um sistema de qualidade apropriado para o escopo de suas atividades, sendo que os procedimentos típicos de controle de qualidade incluem análises de amostras referência e amostras fortificadas, análises em duplicatas, brancos analíticos e participação em ensaios de proficiência (EP). A participação em atividades de EP fornece informações para que o laboratório possa detectar resultados com desempenhos insatisfatórios e aplicar ações corretivas ou preventivas, alcançando um percentual mínimo de acertos para atingir níveis de desempenho satisfatórios. A estrutura organizacional de Ensaio de Proficiência em Laboratórios Analíticos emprega procedimentos operacionais baseados nas normas ABNT ISO/IEC GUIA 43-1:19998 e no Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaio de Proficiência em Laboratórios Analíticos (Químicos).

Baseado nestes critérios e com o propósito de conferir confiança e credibilidade dos resultados fornecidos por laboratórios que executam análise de alimentos utilizados em Nutrição Animal (forrageiras, concentrados e misturas minerais), foi criado e implementado um programa interlaboratorial, intitulado: “Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal (EPLNA)”, cuja estrutura e a normatização foi planejada em conformidade com o Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaio de Proficiência em Laboratórios Analíticos (Químicos).

O EPLNA prevê a avaliação dos principais ensaios executados por laboratórios de Nutrição Animal, tais como: matéria seca (MS), digestibilidade “in vitro” da matéria seca (DIV-MS), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro (FDN), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), lignina, cinzas, nitrogênio não protéico (NNP), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), nitrogênio insolúvel em tampão borato-fosfato (NITBF) e os macro e micro nutrientes (Ca, P, Mg, K, S, Cu, Fe, Mn, Zn e Na).

OBJETIVOS

Entre os objetivos do EPLNA estão: comparar o desempenho de diferentes métodos analíticos utilizados; promover uma melhoria quanto à qualidade dos dados analíticos; produzir materiais de referência para utilização no controle interno de qualidade (CIQ); fornecer regularmente uma avaliação de desempenho enfocando a exatidão e precisão dos resultados analíticos; reduzir a variabilidade dos resultados fornecidos por diferentes laboratórios, assegurando a uniformidade e comparabilidade das medições, e gerar maior confiança dos analistas no fornecimento dos resultados aos clientes.

AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA

O projeto estatístico empregado seguiu os conceitos recomendados pelas normas ABNT ISO/IEC GUIA 43-1 e pelo protocolo internacional harmonizado para ensaio de proficiência em laboratórios analíticos (Químicos). Várias técnicas estatísticas podem ser adotadas para avaliação dos resultados. O EPLNA adotou a técnica do “índice z ” (Fórmula 1), onde x_i é o resultado informado pelo laboratório participante; $\bar{X}$ é o valor designado (é uma estimativa do valor verdadeiro), e foi considerada a média (**M2**) dos resultados após exclusão dos valores discrepantes e “ s ” é o desvio padrão.

$$z = \frac{(x_i - \bar{X})}{s}$$

Fórmula 1. Equação empregada para calcular o **Índice z** .

O critério utilizado para definir o valor designado (**M2**) e o desvio padrão “ s ” dos ensaios foi: considerando todos os resultados enviados pelos participantes, realizou-se a média (**M1**), o desvio padrão (**s**) e o coeficiente de variação (**cv**). Os resultados que ficaram fora do intervalo entre **M1 ± 1s** foram separados. Com os outros dados (os que ficaram entre **M1 ± 1s**), foi determinada a média (**M2**), o respectivo desvio padrão (**s**) e o coeficiente de variação (**cv**).

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS LABORATÓRIOS

O desempenho dos laboratórios foi avaliado para cada ensaio considerando o valor do **Índice z**. Para definir os resultados que estão fora do intervalo de confiança foi adotado o seguinte critério: o resultado que estivesse dentro do intervalo $|z| \leq 2$ foi considerado **satisfatório** e portanto não recebeu asterisco; o resultado que estivesse no intervalo $2 < |z| < 3$ foi considerado resultado **questionável** e recebeu um asterisco (*); e o resultado que estivesse acima do intervalo $|z| \geq 3$ foi considerado **insatisfatório** e recebeu dois asteriscos (**).

Para o ranqueamento dos laboratórios foram considerados a quantidade de ensaios com desempenho satisfatório e o número de ensaios com asteriscos. Foram designados peso dois (2) para os resultados com dois asteriscos (**), **A2**, e peso um (1) para os dados com um asterisco (*), **A1**. O índice de acerto do laboratório (**IA**) foi calculado da seguinte maneira.

$$(N^* = [(AI \times 1) + (A2 \times 2)] / 3)$$

$$\%IA = 100 - \left[\frac{N^* \times 100}{NE} \right]$$

Onde: **N*** quantidade de asteriscos recebidos; **NE**: quantidade de ensaios enviados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Avaliação das amostras do primeiro lote.

Considerando as amostras 01, 03 e 05, dos 37 laboratórios participantes, 32 enviaram resultados nesse primeiro lote. Isso significa 87% de participação (frequência) nesse primeiro lote. Salientamos que os resultados das amostras referência (ARV6, ARM3 E ARC1), apenas serão informados no relatório final. O índice de acertos (IA) foi calculado pela quantidade de resultados satisfatórios obtido pelo laboratório participante. Ele indica quanto o laboratório foi preciso e serve de guia para orientá-lo quanto ao seu desempenho em relação aos outros participantes.

Todas informações relacionadas ao primeiro lote são apresentadas nos anexos: resultados das análises e dados com asteriscos (**Anexo A**); valores do “índice z” (**Anexo B**); gráfico do “índice z” (**Anexo C**) e resumo do desempenho (**Anexo D**).

Amostra de volumoso (am. 01):

- Foram realizadas 357 determinações (média de 11,2 ensaios por laboratório).
- Foram distribuídos 66 asteriscos (média de 2,1 resultados com asterisco por laboratório), sendo 25 dados com um (1) asterisco (desempenho questionável) e 41 dados com dois (2) asterisco (desempenho insatisfatório).
- O valor médio para o índice de acertos (IA) foi de 79,9% (isto significa que em média 79,9% dos resultados enviados obtiveram desempenho satisfatório).
- A média do coeficiente de variação considerando todos os resultados (cv1) foi 48,5% e após a exclusão dos resultados considerados discrepantes (cv2) foi 23,3%. Sendo as análises que apresentaram maior variabilidade considerando o coeficiente de variação foram: entre as análises bromatológicas a lignina com maior cv (cv1=105,8% e cv2=41,6%) e entre as análises de minerais o zinco com maior cv (cv1=124,9% e cv2=34,4%).

Amostra de concentrado (am. 03):

- Foram realizadas 345 determinações (média de 10,8 ensaios por laboratório).
- Foram distribuídos 69 asteriscos (média de 2,2 resultados com asterisco por laboratório), sendo 24 dados com um (1) asterisco (desempenho questionável) e 45 dados com dois (2) asterisco (desempenho insatisfatório).
- O valor médio para o índice de acertos (IA) foi de 76,8% (isto significa que em média 76,8% dos resultados enviados obtiveram desempenho satisfatório).
- A média do coeficiente de variação considerando todos os resultados (cv1) foi 49,1% e após a exclusão dos resultados considerados discrepantes (cv2) foi 20,2%. Sendo as análises que apresentaram maior variabilidade considerando o coeficiente de variação foram: entre as análises bromatológicas a FDA com maior cv (cv1=116,5% e cv2=24,9%) e entre as análises de minerais o magnésio com maior cv (cv1=141,1% e cv2=28,9%).

Amostra de mistura mineral (am. 05):

- Foram realizadas 131 determinações (média de 7,7 ensaios por laboratório).
- Foram distribuídos 28 asteriscos (média de 1,6 resultados com asterisco por laboratório), sendo 7 dados com um (1) asterisco (desempenho questionável) e 21 dados com dois (2) asterisco (desempenho insatisfatório).
- O valor médio para o índice de acertos (IA) foi de 76,0% (isto significa que em média 76,0% dos resultados enviados obtiveram desempenho satisfatório).
- A média do coeficiente de variação considerando todos os resultados (cv1) foi 63,2% e após a exclusão dos resultados considerados discrepantes (cv2) foi 19,0%. Sendo as análises que apresentaram maior variabilidade considerando o coeficiente de variação foram: entre os macronutrientes o sódio apresentou o maior cv (cv1=160,6% e cv2=52,4%) e os micronutrientes o cobre com o maior cv (cv1=124,9% e cv2=41,3%).

Gilberto Batista de Souza
Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal

ANEXO A: Resultados das análises das amostras 9/01, 9/03 e 9/05.




EPLNA ANO 9 - RESULTADOS DE ANÁLISES 1º LOTE - AMOSTRA 01 (VOLUMOSO)													
LAB	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
% (m/m)													
1	91,73		39,04	78,02	**12,71	**2,12		**4,05	34,05				
2	90,82	59,57	37,37	81,15	8,30	1,40	4,35	**3,98	30,82				
3	90,79		38,10	*82,66	8,30	**0,76	**14,67	4,59	31,69	0,58			
4	91,45				8,80	1,76		4,40	36,09				
5													
6	91,70			80,38	*9,48	1,45	**38,54	4,27					
7	91,11			77,35	8,62			4,74	33,33				
8	**88,92		38,79	76,94	9,36	1,61	6,59	4,87					
9	91,84					1,58		4,54					
10	91,00				8,69								
11	**92,51		37,96	77,90	9,01	1,26	5,34	4,73	32,80		0,22	0,06	
12	90,80												
13	90,46	58,25	37,07	78,86	8,62	1,59		4,53					
14	91,05				9,06	1,52		**5,89					
15	*91,90				8,38			4,24					
16	90,94	57,53	38,46	78,87	8,24	1,33	4,96	4,57	**55,53		**5,28	**2,64	
17													
18	90,51	**62,78	38,82	78,62	8,83	1,00	5,02	4,57	33,13				
19	90,13		36,51	80,69	9,01		4,43	4,74					
20	*92,00		37,33	80,69	*7,97		5,15	*4,94					
21	*89,89		39,65	79,02	8,41	*0,80	5,64	*4,07	31,13	**2,91			
22	91,32	58,25	38,81	*74,57	8,78	1,38	7,12	4,67		0,28	0,25	0,09	0,98
23	90,14		**33,37		**10,11	**0,65		4,85	35,78	0,06		*1,10	
24	90,35		36,21	77,46	8,99		5,31	4,64					
25	91,23		37,65		9,11	1,68	4,78	*4,15	31,05				
26	90,66		**51,43	**89,18	9,12	**0,76		*4,12					
27													
28	91,30	**63,40			8,00	1,20		4,40					
29	91,00	*56,01	38,67	**73,72	8,65	1,30	6,25	4,30	32,73	0,39	0,62	0,13	0,94
30	**92,72		35,66	**72,62	8,83	0,98	4,94	**3,98	30,36	0,20	0,55	0,11	0,87
31													
32	90,94		37,17	77,81	8,51		4,38	4,58			0,62		
33	90,63		*40,67	76,07	8,76	1,36		4,57					
34	**87,91		39,31	78,60	*7,90	1,37	4,96	4,49					
35	91,03				8,20			4,54	30,88				
36	91,31		38,33	81,57	8,65	1,45	4,75	4,74	32,20	0,21	0,72	0,23	
37													
MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF	
m1	90,94	59,40	38,94	78,76	8,85	1,32	7,62	4,53	34,10	0,66	1,18	0,62	0,93
s	0,94	2,74	3,92	3,41	0,87	0,36	8,06	0,37	34,10	1,01	1,82	0,96	0,93
Cv	1,03	4,62	10,06	4,33	9,84	27,35	105,80	8,26	18,11	151,95	154,07	154,52	5,99
m1-s	90,00	56,66	35,02	75,35	7,98	0,96	-0,44	4,16	27,93	-0,35	-0,64	-0,34	0,87
m1+s	91,88	62,14	42,86	82,17	9,72	1,68	15,68	4,90	40,27	1,67	3,00	1,58	0,99
MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF	
m2	90,97	58,40	38,08	78,82	8,72	1,38	5,80	4,57	32,57	0,29	0,50	0,29	0,93
s	0,46	0,85	1,23	1,58	0,37	0,20	2,41	0,17	1,80	0,18	0,21	0,40	0,06
Cv	0,51	1,46	3,23	2,01	4,20	14,23	41,56	3,81	5,51	62,70	42,29	140,45	5,99
m2-s	90,51	57,55	36,85	77,24	8,35	1,18	3,39	4,40	30,77	0,11	0,29	-0,11	0,87
m2+s	91,43	59,25	39,31	80,40	9,09	1,58	8,21	4,74	34,37	0,47	0,71	0,69	0,99

EPLNA ANO 9 - RESULTADOS DE ANÁLISES 1º LOTE - AMOSTRA 01 (VOLUMOSO)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
	g kg ⁻¹ (m/m)					mg kg ⁻¹ (m/m)			
1									
2									
3	3,63	2,67	1,70	11,90	0,28	11,01	**416,35	37,23	*143,19
4	3,19	3,36	*2,16	*9,00	0,89	**16,34	309,14	35,35	*145,97
5									
6									
7	3,24	3,34	1,66	11,91		9,35	285,65	27,88	127,13
8									
9									
10	2,10	2,80	**4,40		*1,36			**200,00	
11	3,06		1,52						
12	3,33			12,33	0,05		300,70	21,70	132,00
13									
14	3,10	2,56	1,72	10,64	0,84	7,96	353,40	11,64	109,16
15	2,24	2,86	1,64			11,40	294,00	29,40	129,00
16									
17									
18	3,90	*3,50	1,40	**14,70		8,84	270,71	35,36	132,59
19									
20	3,47	2,86	1,68	11,23	0,95	7,61	310,89	36,96	124,46
21	2,60	2,25	1,40	**8,60	0,24	5,98	**113,20	18,80	**92,53
22	3,39	2,43	1,49	10,96		**15,14	252,13	22,62	108,63
23	*4,40	2,53	1,65	9,80	0,90	7,10	285,00	14,00	**52,00
24	2,66	2,19	1,49	*9,06	0,25	**3,57	233,67	17,36	119,24
25									
26									
27									
28	**0,20	**0,22	**0,10						
29	2,70	2,90	1,60	**13,90	0,10	9,50	302,62	21,01	119,53
30									
31									
32									
33									
34									
35	2,90	2,60	1,60	10,70	0,40				
36	3,55	2,87	*1,11	11,01	0,09	8,58	336,68	22,27	119,34
37									
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m1	2,98	2,62	1,67	11,12	0,53	9,41	290,30	36,77	118,20
s	0,90	0,74	0,82	1,77	0,43	3,48	67,67	45,92	0,06
Cv	30,06	28,31	49,13	15,87	82,15	36,92	23,31	124,87	19,98
m1-s	2,08	1,88	0,85	9,35	0,10	5,93	222,63	-9,15	94,59
m1+s	3,88	3,36	2,49	12,89	0,96	12,89	357,97	82,69	141,81
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m2	3,01	2,73	1,59	11,16	0,54	8,73	294,55	25,11	122,11
s	0,47	0,35	0,22	0,78	0,35	1,68	33,12	8,64	8,55
Cv	15,50	12,68	14,09	6,99	64,45	19,24	11,24	34,41	7,00
m2-s	2,54	2,38	1,37	10,38	0,19	7,05	261,43	16,47	113,56
m2+s	3,48	3,08	1,81	11,94	0,89	10,41	327,67	33,75	130,66

EPLNA ANO 9 - RESULTADOS DE ANÁLISES 1º LOTE - AMOSTRA 03 (CONCENTRADO)													
LAB	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
% (m/m)													
1	*96,27		3,74	9,67	*23,01	11,20		10,19	3,13				
2	95,60	84,70	3,95	11,35	**27,44	11,27	0,34	**9,74	2,84				
3	94,69		4,52	11,20	24,41	11,05	1,29	10,79	2,48	0,88			
4	**92,43				23,67	11,62		10,28	**4,91				
5													
6	95,38		**7,59	10,74	24,53	*12,97	**4,43	10,45					
7	**96,73			**42,33	24,72			10,93	3,21				
8	*93,41		5,13		**27,11	11,91	1,45	*11,10					
9	94,76					11,93		10,72					
10	95,05				23,40								
11	95,42		4,05	8,41	25,33	11,46	0,73	10,24	**1,59		0,15	0,27	
12	95,60												
13	94,39	84,39	3,87	7,46	25,05	11,21		10,44					
14	**93,14				25,20	**3,60		10,67					
15	94,80				23,80			*10,00					
16	95,62	80,93	3,49	8,45	23,70	11,89	0,26	*9,92	**4,63				
17													
18	95,92	89,30	5,06	10,33	25,95	10,80	0,40	10,66	3,19				
19	94,88		3,41	9,64	25,92		0,45	10,54					
20	95,67		3,65	**20,63	23,57			10,79					
21	95,50		4,54	7,67	24,09	11,13	1,39	10,32	**1,16	**5,50			
22	95,30	*92,48	5,56	13,29	24,36	11,48	**4,14	10,24		1,11			2,15
23	93,97		**36,85		25,62	11,03		10,81	2,55	0,02		**0,94	
24	94,83				25,89			10,83					
25	94,03				**21,44	*9,80		**9,90	3,73				
26	94,46		**16,99	**26,46	**30,16	**0,86		*11,04					
27													
28	94,40				24,90	11,20		10,40					
29	95,30	79,18	5,60	9,43	24,30	12,35	1,24	10,75	3,73	1,26	**0,23	0,36	**2,58
30	95,27		3,61	7,24	24,14	11,58	0,49	**9,68	2,71	0,73	0,14	0,08	2,18
31													
32	94,11		3,64	6,77	24,34		0,42	10,78			*0,05		
33	94,20		2,99	13,69	24,68	11,26		10,73					
34	**92,04		4,21	8,43	**27,36	10,87	0,76	10,92					
35	94,92				23,91	10,19		10,54	2,72				
36	95,34		3,73	10,00	24,48	11,35	*1,95	10,72	3,75	0,75	0,10	0,05	
37													
	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
m1	94,79	85,16	6,48	12,66	24,88	10,58	1,32	10,50	3,09	1,46	0,13	0,34	2,30
s	1,03	5,00	7,55	8,44	1,62	2,68	1,31	0,38	3,09	1,82	0,07	0,36	2,30
Cv	1,08	5,88	116,49	66,68	6,53	25,33	99,28	3,65	32,32	124,47	49,67	105,74	10,42
m1-s	93,76	80,16	-1,07	4,22	23,26	7,90	0,01	10,12	2,09	-0,36	0,06	-0,02	2,06
m1+s	95,82	90,16	14,03	21,10	26,50	13,26	2,63	10,88	4,09	3,28	0,20	0,70	2,54
	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
m2	94,94	84,83	4,33	10,24	24,58	11,34	0,86	10,57	3,09	0,79	0,13	0,19	2,17
s	0,54	3,44	1,08	3,24	0,77	0,67	0,54	0,22	0,48	0,43	0,03	0,15	0,02
Cv	0,57	4,05	24,90	31,60	3,12	5,87	62,98	2,07	15,46	54,46	20,35	78,65	0,98
m2-s	94,40	81,39	3,25	7,00	23,81	10,67	0,32	10,35	2,61	0,36	0,10	0,04	2,15
m2+s	95,48	88,27	5,41	13,48	25,35	12,01	1,40	10,79	3,57	1,22	0,16	0,34	2,19

EPLNA ANO 9 - RESULTADOS DE ANÁLISES 1º LOTE - AMOSTRA 03 (CONCENTRADO)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
	g kg ⁻¹ (m/m)					mg kg ⁻¹ (m/m)			
1									
2									
3	25,19	2,44	13,51	9,08	4,71	28,51	*1332,77	43,62	*130,95
4	25,31	2,36	**17,21	7,71	6,31	*36,06	1077,37	*67,24	103,82
5									
6									
7	23,45	2,43	14,20	9,42		**16,65	**1935,05	48,85	102,70
8									
9									
10	**6,80	1,90	**1,24		7,70			**235,00	
11	23,66		13,72						
12	27,76			7,09	5,40		904,30	39,60	110,20
13									
14	**3,11	**20,32	15,06	**12,16	*8,54	24,86	947,55	28,97	*128,25
15	15,60	2,27	13,30			*35,70	800,00	50,10	124,00
16									
17									
18	23,70	2,90	14,50	**12,30		31,80	800,93	57,86	107,39
19									
20	22,05	2,75	13,27	9,54	6,32	28,22	921,57	54,35	116,72
21	23,20	1,79	11,80	7,62	*8,80	24,23	*453,00	36,48	*80,95
22	17,25	2,02	11,88	6,81		32,62	841,32	42,12	92,14
23	24,59	2,12	12,74	7,95	*8,69	27,56	815,00	33,00	**41,00
24	20,00	1,82		7,42	4,68	25,82	761,95	37,67	106,67
25									
26									
27									
28	**2,03	**0,22	**1,01						
29	18,20	2,30	12,70	10,80	5,30	31,08	953,07	36,34	103,07
30									
31									
32									
33									
34									
35	23,50	2,10	13,90	9,40	6,70				
36	*30,85	2,30	11,50	9,19	5,27	30,57	**1957,77	42,55	101,22
37									
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m1	19,79	3,25	11,97	9,04	6,54	28,74	1035,83	56,92	103,51
s	8,16	4,59	4,45	1,76	1,55	5,22	430,17	50,29	0,24
Cv	41,22	141,10	37,21	19,51	23,73	18,16	41,53	88,36	21,74
m1-s	11,63	-1,34	7,52	7,28	4,99	23,52	605,66	6,63	81,01
m1+s	27,95	7,84	16,42	10,80	8,09	33,96	1466,00	107,21	126,01
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m2	22,39	2,11	13,24	8,81	6,14	28,53	923,26	44,20	106,79
s	3,42	0,61	1,08	1,09	0,90	2,95	163,68	10,48	8,77
Cv	15,29	28,86	8,18	12,39	14,59	10,35	17,73	23,70	8,21
m2-s	18,97	1,50	12,16	7,72	5,24	25,58	759,58	33,72	98,02
m2+s	25,81	2,72	14,32	9,90	7,04	31,48	1086,94	54,68	115,56

EPLNA ANO 9 - RESULTADOS DE ANÁLISES 1º LOTE - AMOSTRA 05 (Mistura Mineral)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
	g kg ⁻¹ (m/m)					mg kg ⁻¹ (m/m)			
1									
2									
3	178,72	14,45	58,99	4,80	1,22	2590,00	**34250,00	17530,00	*9230,00
4	182,27	16,91	**88,60	3,23	3,26	3794,40	23948,93	**59567,00	*8910,00
5									
6									
7	203,58	*18,75	53,34	3,89		2225,36	23756,70	18587,77	5828,33
8									
9									
10	**106,00	**8,60	62,00		1,30			15900,00	8160,00
11	178,96		67,08						
12	171,50			5,36	2,62		21244,00	23811,00	6683,00
13									
14	*230,02	**23,00	69,43	**0,53	**34,41	*6091,70	**3354,09	**2029,71	5692,84
15	202,00	16,10	64,40			3038,00	18473,00	23909,00	7720,00
16									
17									
18									
19									
20	188,70	15,83	61,20	4,60	*7,23	**21400,00	**7144,00	17738,00	**2355,00
21	198,10	13,81	64,85	3,95	4,30	2455,00	**5312,50	18812,50	6713,35
22	192,26	14,18	57,95	**6,56	3,29	2082,50	20206,75	17478,25	6314,00
23	182,00	15,70	56,30	4,20	3,30	2114,00	19833,00	16013,00	6917,00
24	188,76	13,71	54,25	3,81	1,90	2658,33	**20,77	**15,95	**7,02
25									
26									
27									
28	**15,75	**1,66	**5,32						
29	*137,00	14,70	65,40	5,20	2,16	1990,72	22045,80	14369,75	7534,70
30									
31									
32									
33									
34									
35	177,70	14,60	62,10	4,40	2,60	2389,00	21860,00	18716,00	7207,00
36	168,61	15,40	65,70	4,03	3,83	2112,77	19309,25	18310,12	7540,23
37									
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m1	170,70	14,49	59,81	4,20	5,49	4226,29	17197,06	18852,54	6454,16
s	48,23	4,66	16,65	1,39	8,82	5277,23	9576,03	13059,72	0,00
Cv	28,26	32,13	27,84	33,15	160,63	124,87	55,68	69,27	37,24
m1-s	122,47	9,83	43,16	2,81	-3,33	-1050,94	7621,03	5792,82	4050,95
m1+s	218,93	19,15	76,46	5,59	14,31	9503,52	26773,09	31912,26	8857,37
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
m2	182,15	15,35	61,64	4,32	3,08	2795,15	21186,38	18431,28	6937,31
s	16,81	1,45	4,90	0,64	1,62	1155,05	1907,59	2863,01	786,32
Cv	9,23	9,45	7,95	14,73	52,38	41,32	9,00	15,53	11,33
m2-s	165,34	13,90	56,74	3,68	1,46	1640,10	19278,79	15568,27	6150,99
m2+s	198,96	16,80	66,54	4,96	4,70	3950,20	23093,97	21294,29	7723,63

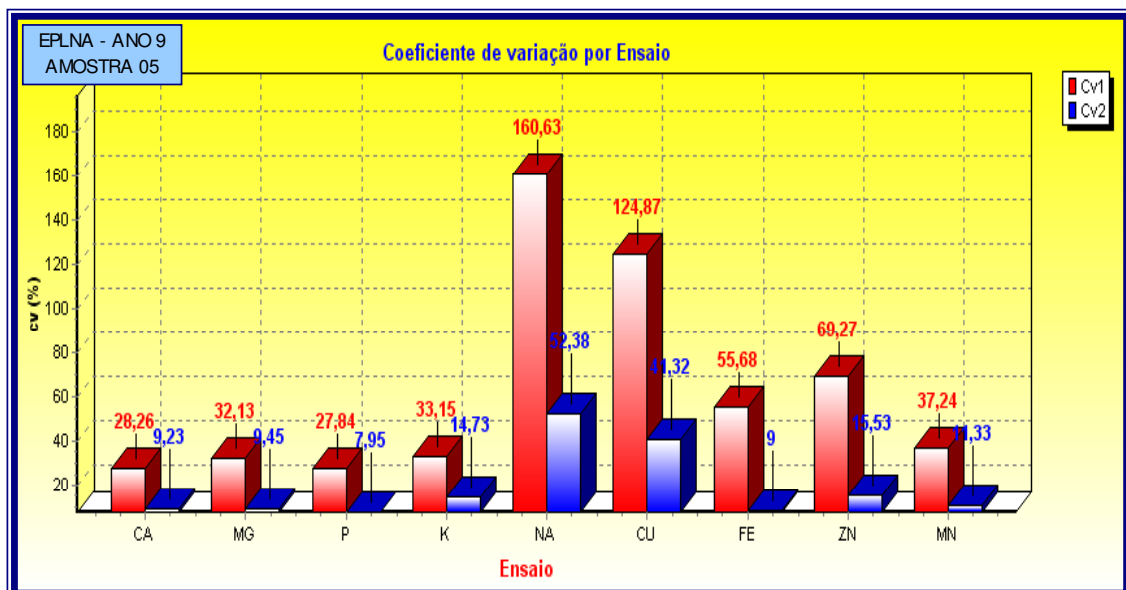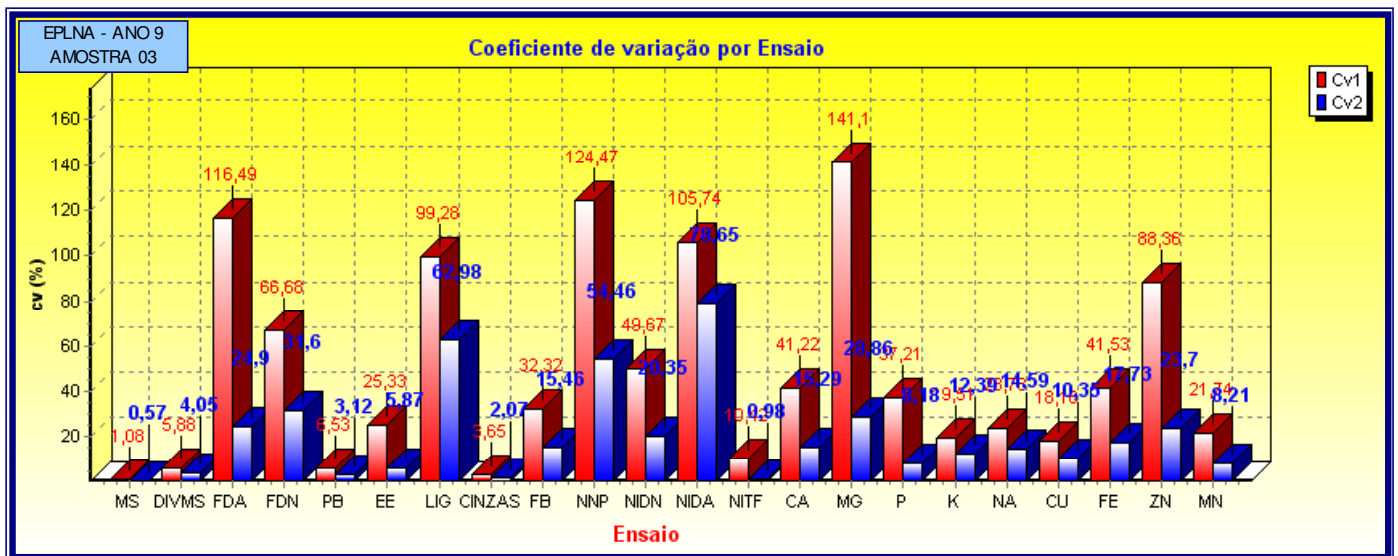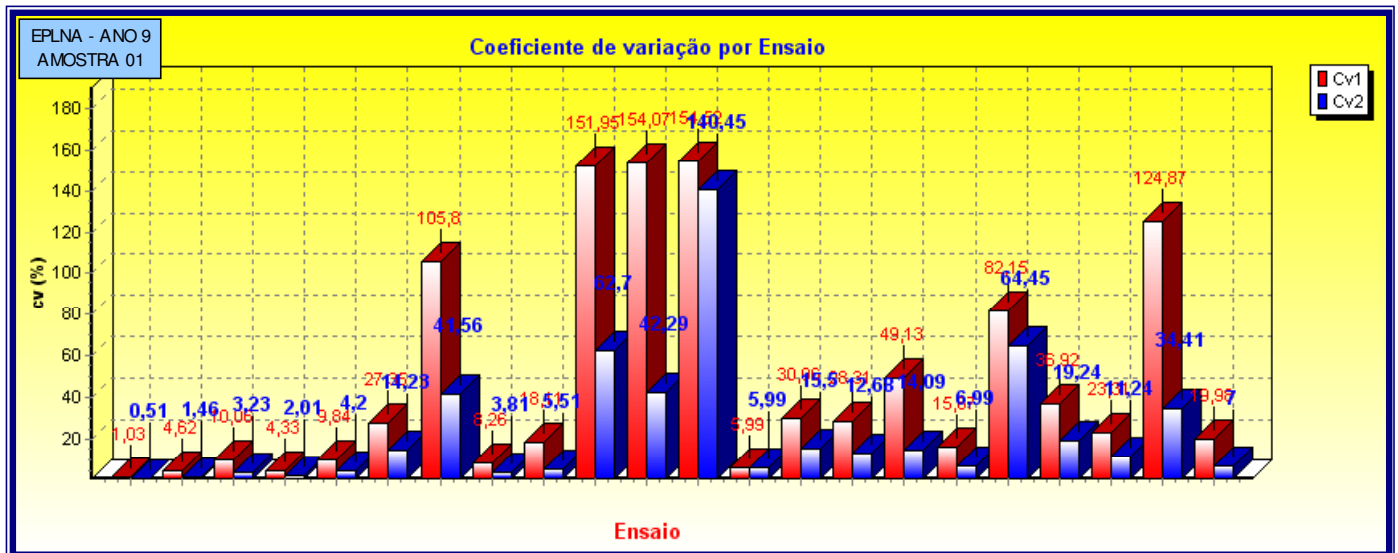

ANEXO B: Valores para o índice z das análises das amostras 9/01, 9/03 e 9/05.

EPLNA ANO 9 – ÍNDICE Z - 1º LOTE - AMOSTRA 01 (VOLUMOSO)													
LAB	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
ÍNDICE Z													
1	1,6		0,8	-0,5	10,8	3,7		-3,1	0,8				
2	-0,3	1,4	-0,6	1,5	-1,1	0,1	-0,6	-3,5	-1,0				
3	-0,4		0,0	2,4	-1,1	-3,1	3,7	0,1	-0,5	1,6			
4	1,0				0,2	1,9		-1,0	2,0				
5													
6	1,6		9,1	1,0	2,0	0,3	13,6	-1,8					
7	0,3			-0,9	-0,3			1,0	0,4				
8	-4,5		0,6	-1,2	1,7	1,1	0,3	1,8					
9	1,9					1,0		-0,2					
10	0,1				-0,1								
11	3,3		-0,1	-0,6	0,8	-0,6	-0,2	0,9	0,1		-1,3	-0,6	
12	-0,4												
13	-1,1	-0,2	-0,8	0,0	-0,3	1,0		-0,2					
14	0,2				0,9	0,7		7,8					
15	2,0				-0,9			-1,9					
16	-0,1	-1,0	0,3	0,0	-1,3	-0,3	-0,3	0,0	12,8		22,8	5,9	
17													
18	-1,0	5,2	0,6	-0,1	0,3	-1,9	-0,3	0,0	0,3				
19	-1,8		-1,3	1,2	0,8		-0,6	1,0					
20	2,2		-0,6	1,2	-2,0		-0,3	2,2					
21	-2,3		1,3	0,1	-0,8	-2,9	-0,1	-2,9	-0,8	14,6			
22	0,8	-0,2	0,6	-2,7	0,2	0,0	0,6	0,6		-0,1	-1,2	-0,5	0,8
23	-1,8		-3,8		3,8	-3,7		1,6	1,8	-1,3		2,0	
24	-1,4		-1,5	-0,9	0,7		-0,2	0,4					
25	0,6		-0,3		1,0	1,5	-0,4	-2,5	-0,8				
26	-0,7		10,9	6,6	1,1	-3,1		-2,7					
27													
28	0,7	5,9			-2,0	-0,9		-1,0					
29	0,1	-2,8	0,5	-3,2	-0,2	-0,4	0,2	-1,6	0,1	0,6	0,6	-0,4	0,2
30	3,8		-2,0	-3,9	0,3	-2,0	-0,4	-3,5	-1,2	-0,5	0,2	-0,4	-1,0
31													
32	-0,1		-0,7	-0,6	-0,6		-0,6	0,1			0,6		
33	-0,7		2,1	-1,7	0,1	-0,1		0,0					
34	-6,7		1,0	-0,1	-2,2	-0,1	-0,3	-0,5					
35	0,1				-1,4			-0,2	-0,9				
36	0,7		0,2	1,7	-0,2	0,3	-0,4	1,0	-0,2	-0,4	1,0	-0,2	
37													
MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF	
VALOR ALVO PARA A MÉDIA $[X]$													
m2	90,97	58,40	38,08	78,82	8,72	1,38	5,80	4,57	32,57	0,29	0,50	0,29	0,93
VALOR ALVO PARA O DESVIO PADRÃO $[s]$													
s	0,46	0,85	1,23	1,58	0,37	0,20	2,41	0,17	1,80	0,18	0,21	0,40	0,06

EPLNA ANO 9 – ÍNDICE Z - 1º LOTE - AMOSTRA 01 (VOLUMOSO)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
ÍNDICE Z									
1									
2									
3	1,3	-0,2	0,5	0,9	-0,7	1,4	3,7	1,4	2,5
4	0,4	1,8	2,6	-2,8	1,0	4,5	0,4	1,2	2,8
5									
6									
7	0,5	1,7	0,3	1,0		0,4	-0,3	0,3	0,6
8									
9									
10	-1,9	0,2	12,8		2,3			20,2	
11	0,1		-0,3						
12	0,7			1,5	-1,4		0,2	-0,4	1,2
13									
14	0,2	-0,5	0,6	-0,7	0,9	-0,5	1,8	-1,6	-1,5
15	-1,6	0,4	0,2			1,6	0,0	0,5	0,8
16									
17									
18	1,9	2,2	-0,9	4,5		0,1	-0,7	1,2	1,2
19									
20	1,0	0,4	0,4	0,1	1,2	-0,7	0,5	1,4	0,3
21	-0,9	-1,4	-0,9	-3,3	-0,9	-1,6	-5,5	-0,7	-3,5
22	0,8	-0,9	-0,4	-0,3		3,8	-1,3	-0,3	-1,6
23	3,0	-0,6	0,3	-1,7	1,0	-1,0	-0,3	-1,3	-8,2
24	-0,7	-1,5	-0,4	-2,7	-0,8	-3,1	-1,8	-0,9	-0,3
25									
26									
27									
28	-6,0	-7,2	-6,8						
29	-0,7	0,5	0,1	3,5	-1,3	0,5	0,2	-0,5	-0,3
30									
31									
32									
33									
34									
35	-0,2	-0,4	0,1	-0,6	-0,4				
36	1,1	0,4	-2,2	-0,2	-1,3	-0,1	1,3	-0,3	-0,3
37									
Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn	
VALOR ALVO PARA A MÉDIA $[X]$									
m2	3,01	2,73	1,59	11,16	0,54	8,73	294,55	25,11	122,11
VALOR ALVO PARA O DESVIO PADRÃO $[s]$									
s	0,47	0,35	0,22	0,78	0,35	1,68	33,12	8,64	8,55









EPLNA ANO 9 – ÍNDICE Z - 1º LOTE - AMOSTRA 03 (VOLUMOSO)													
LAB	MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF
ÍNDICE Z													
1	2,5		-0,6	-0,2	-2,0	-0,2		-1,7	0,1				
2	1,2	0,0	-0,3	0,3	3,7	-0,1	-1,0	-3,8	-0,5				
3	-0,5		0,2	0,3	-0,2	-0,4	0,8	1,0	-1,3	0,2			
4	-4,7				-1,2	0,4		-1,3	3,8				
5													
6	0,8		3,0	0,2	-0,1	2,4	6,6	-0,6					
7	3,3			9,9	0,2			1,6	0,3				
8	-2,8		0,7		3,3	0,9	1,1	2,4					
9	-0,3					0,9		0,7					
10	0,2				-1,5								
11	0,9		-0,3	-0,6	1,0	0,2	-0,2	-1,5	-3,1		0,7	0,5	
12	1,2												
13	-1,0	-0,1	-0,4	-0,9	0,6	-0,2		-0,6					
14	-3,3				0,8	-11,6		0,4					
15	-0,3				-1,0			-2,6					
16	1,3	-1,1	-0,8	-0,6	-1,1	0,8	-1,1	-3,0	3,2				
17													
18	1,8	1,3	0,7	0,0	1,8	-0,8	-0,9	0,4	0,2				
19	-0,1		-0,9	-0,2	1,7		-0,8	-0,1					
20	1,4		-0,6	3,2	-1,3			1,0					
21	1,0		0,2	-0,8	-0,6	-0,3	1,0	-1,1	-4,0	10,9			
22	0,7	2,2	1,1	0,9	-0,3	0,2	6,1	-1,5		0,7			-1,0
23	-1,8		30,1		1,4	-0,5		1,1	-1,1	-1,8		5,0	
24	-0,2				1,7			1,2					
25	-1,7				-4,1	-2,3		-3,0	1,3				
26	-0,9		11,7	5,0	7,3	-15,6		2,1					
27													
28	-1,0				0,4	-0,2		-0,8					
29	0,7	-1,6	1,2	-0,3	-0,4	1,5	0,7	0,8	1,3	1,1	3,3	1,1	20,5
30	0,6		-0,7	-0,9	-0,6	0,4	-0,7	-4,1	-0,8	-0,1	0,3	-0,7	0,5
31													
32	-1,5		-0,6	-1,1	-0,3		-0,8	0,9			-2,7		
33	-1,4		-1,2	1,1	0,1	-0,1		0,7					
34	-5,4		-0,1	-0,6	3,6	-0,7	-0,2	1,6					
35	0,0				-0,9	-1,7		-0,1	-0,8				
36	0,7		-0,6	-0,1	-0,1	0,0	2,0	0,7	1,4	-0,1	-1,0	-0,9	
37													
MS	DIVMS	FDA	FDN	PB	EE	LIG	CINZAS	FB	NNP	NIDN	NIDA	NITBF	
VALOR ALVO PARA A MÉDIA $[X]$													
m2	94,94	84,83	4,33	10,24	24,58	11,34	0,86	10,57	3,09	0,79	0,13	0,19	2,17
VALOR ALVO PARA O DESVIO PADRÃO $[s]$													
s	0,54	3,44	1,08	3,24	0,77	0,67	0,54	0,22	0,48	0,43	0,03	0,15	0,02

EPLNA ANO 9 – ÍNDICE Z - 1º LOTE - AMOSTRA 03 (VOLUMOSO)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
	ÍNDICE Z								
1									
2									
3	0,8	0,5	0,3	0,3	-1,6	0,0	2,5	-0,1	2,8
4	0,9	0,4	3,7	-1,0	0,2	2,5	0,9	2,2	-0,3
5									
6									
7	0,3	0,5	0,9	0,6		-4,0	6,2	0,4	-0,5
8									
9									
10	-4,6	-0,3	-11,1		1,7			18,2	
11	0,4		0,4						
12	1,6			-1,6	-0,8		-0,1	-0,4	0,4
13									
14	-5,6	29,9	1,7	3,1	2,7	-1,2	0,2	-1,5	2,5
15	-2,0	0,3	0,1			2,4	-0,8	0,6	2,0
16									
17									
18	0,4	1,3	1,2	3,2		1,1	-0,8	1,3	0,1
19									
20	-0,1	1,0	0,0	0,7	0,2	-0,1	0,0	1,0	1,1
21	0,2	-0,5	-1,3	-1,1	3,0	-1,5	-2,9	-0,7	-3,0
22	-1,5	-0,2	-1,3	-1,8		1,4	-0,5	-0,2	-1,7
23	0,6	0,0	-0,5	-0,8	2,8	-0,3	-0,7	-1,1	-7,5
24	-0,7	-0,5		-1,3	-1,6	-0,9	-1,0	-0,6	0,0
25									
26									
27									
28	-5,9	-3,1	-11,3						
29	-1,2	0,3	-0,5	1,8	-0,9	0,9	0,2	-0,8	-0,4
30									
31									
32									
33									
34									
35	0,3	0,0	0,6	0,5	0,6				
36	2,5	0,3	-1,6	0,3	-1,0	0,7	6,3	-0,2	-0,6
37									
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
VALOR ALVO PARA A MÉDIA $[X]$									
m2	22,39	2,11	13,24	8,81	6,14	28,53	923,26	44,20	106,79
VALOR ALVO PARA O DESVIO PADRÃO $[s]$									
s	3,42	0,61	1,08	1,09	0,90	2,95	163,68	10,48	8,77

EPLNA ANO 9 – ÍNDICE Z - 1º LOTE - AMOSTRA 05 (VOLUMOSO)									
LAB	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
	ÍNDICE Z								
1									
2									
3	-0,2	-0,6	-0,5	0,8	-1,1	-0,2	6,8	-0,3	2,9
4	0,0	1,1	5,5	-1,7	0,1	0,9	1,5	14,4	2,5
5									
6									
7	1,3	2,3	-1,7	-0,7		-0,5	1,4	0,1	-1,4
8									
9									
10	-4,5	-4,7	0,1		-1,1			-0,9	1,5
11	-0,2		1,1						
12	-0,6			1,6	-0,3		0,0	1,9	-0,3
13									
14	2,8	5,3	1,6	-5,9	19,3	2,8	-9,4	-5,7	-1,6
15	1,2	0,5	0,6			0,2	-1,4	1,9	1,0
16									
17									
18									
19									
20	0,4	0,3	-0,1	0,4	2,6	16,1	-7,4	-0,2	-5,8
21	0,9	-1,1	0,7	-0,6	0,8	-0,3	-8,3	0,1	-0,3
22	0,6	-0,8	-0,8	3,5	0,1	-0,6	-0,5	-0,3	-0,8
23	0,0	0,2	-1,1	-0,2	0,1	-0,6	-0,7	-0,8	0,0
24	0,4	-1,1	-1,5	-0,8	-0,7	-0,1	-11,1	-6,4	-8,8
25									
26									
27									
28	-9,9	-9,4	-11,5						
29	-2,7	-0,4	0,8	1,4	-0,6	-0,7	0,4	-1,4	0,8
30									
31									
32									
33									
34									
35	-0,3	-0,5	0,1	0,1	-0,3	-0,3	0,3	0,1	0,3
36	-0,8	0,0	0,8	-0,4	0,5	-0,6	-1,0	0,0	0,8
37									
	Ca	Mg	P	K	Na	Cu	Fe	Zn	Mn
VALOR ALVO PARA A MÉDIA $[X]$									
m2	182,15	15,35	61,64	4,32	3,08	2795,15	21186,38	18431,28	6937,31
VALOR ALVO PARA O DESVIO PADRÃO $[s]$									
s	16,81	1,45	4,90	0,64	1,62	1155,05	1907,59	2863,01	786,32









ANEXO C: Gráficos do índice z das análises das amostras 9/01, 9/03 e 9/05.

EPLNA ANO 9 (2006)
Gráficos do Índice z - Amostra 01 (volumoso)

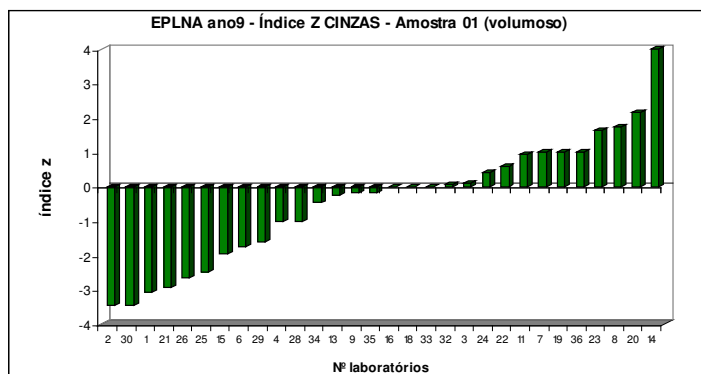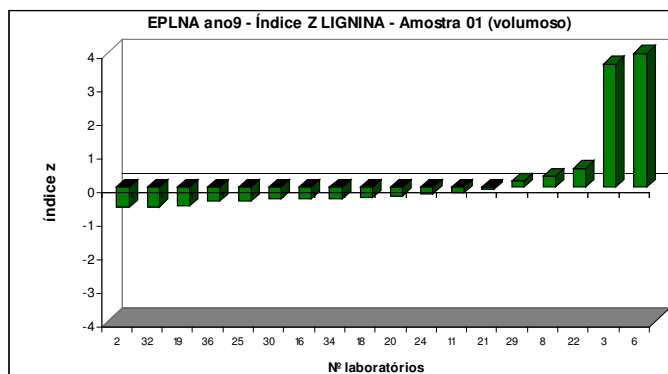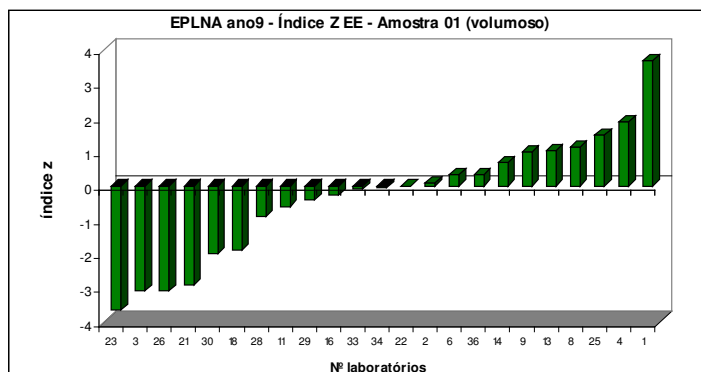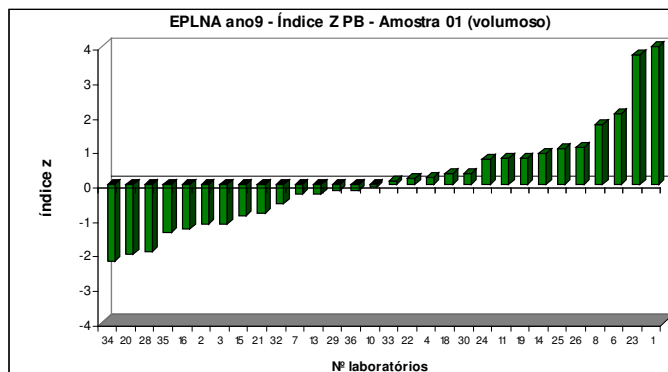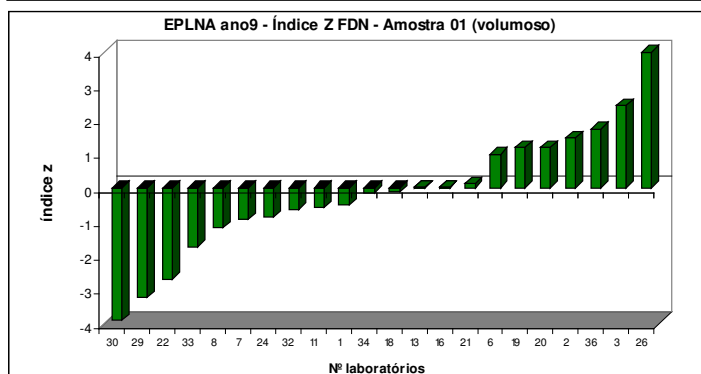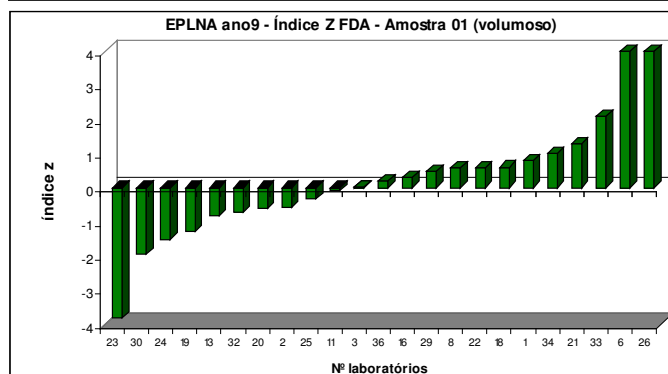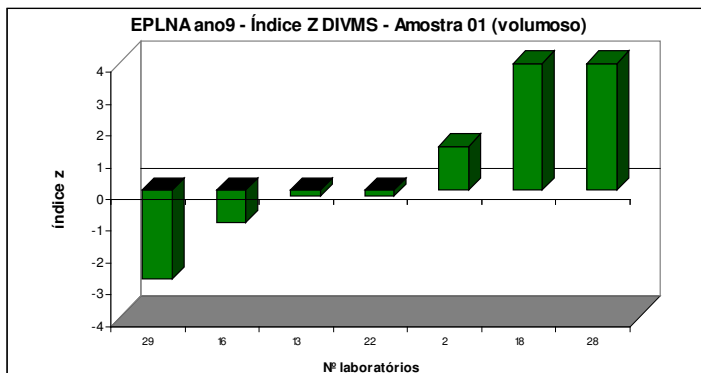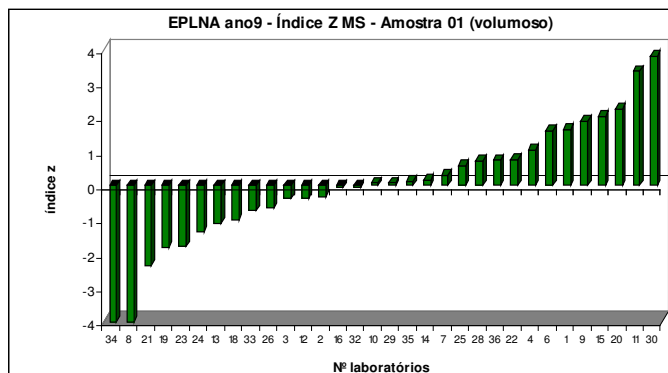


EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 01 (volumoso)

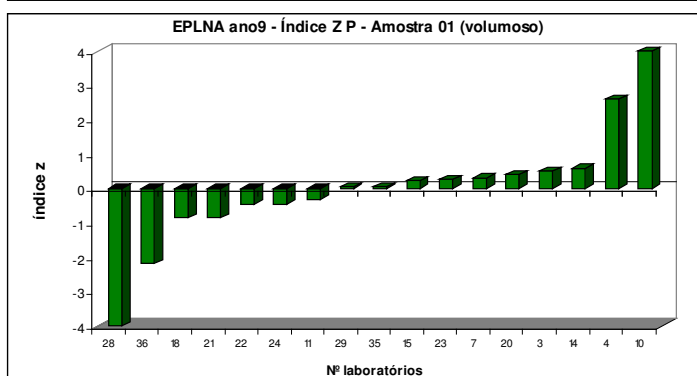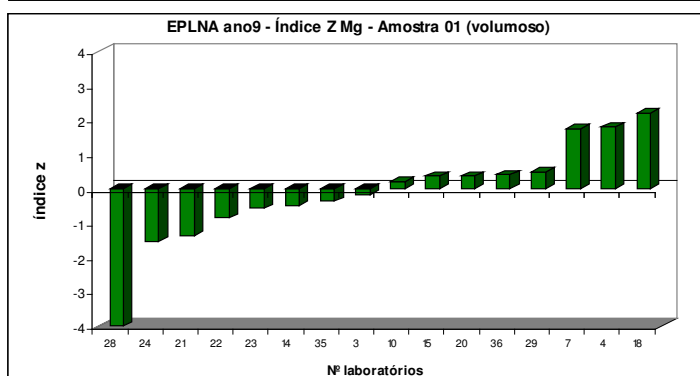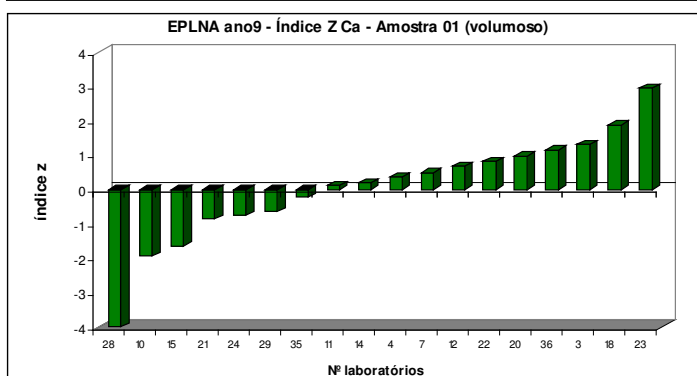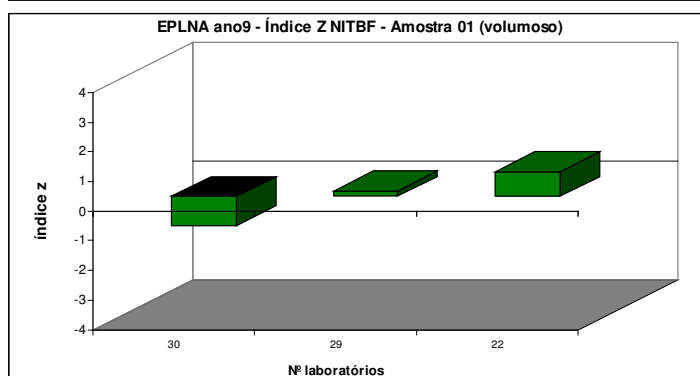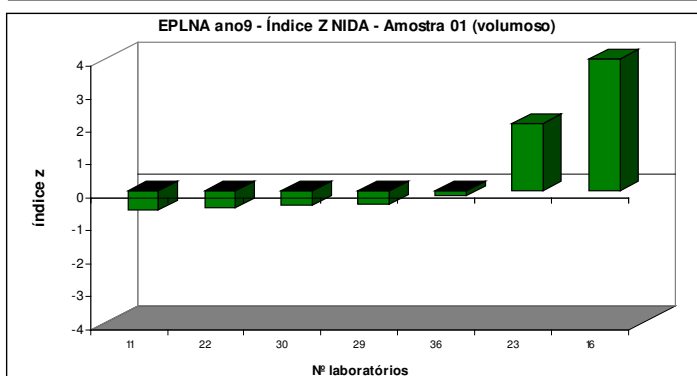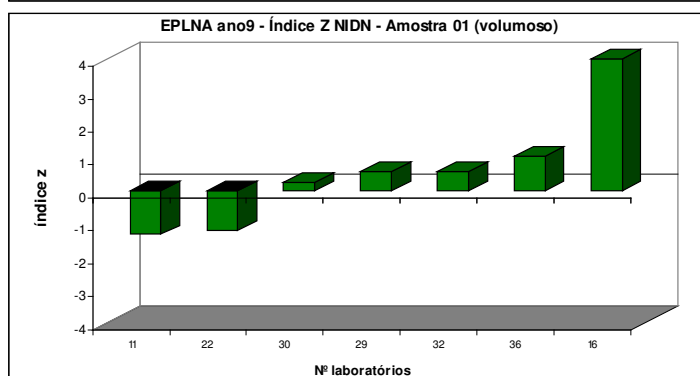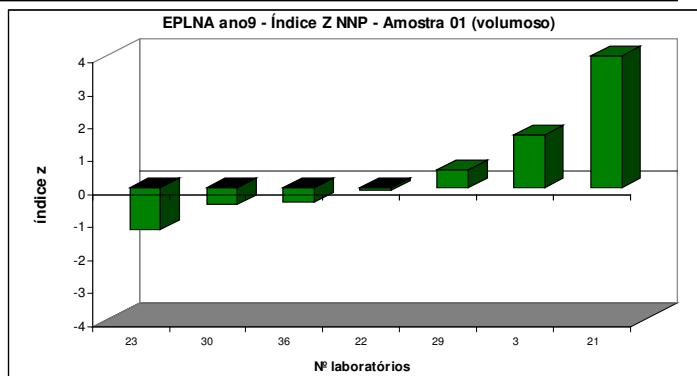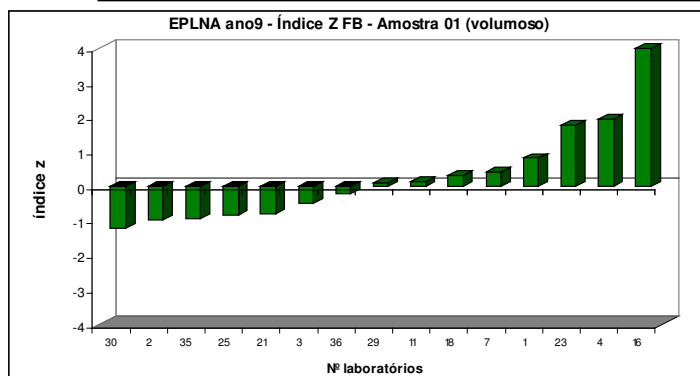









EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 01 (volumoso)

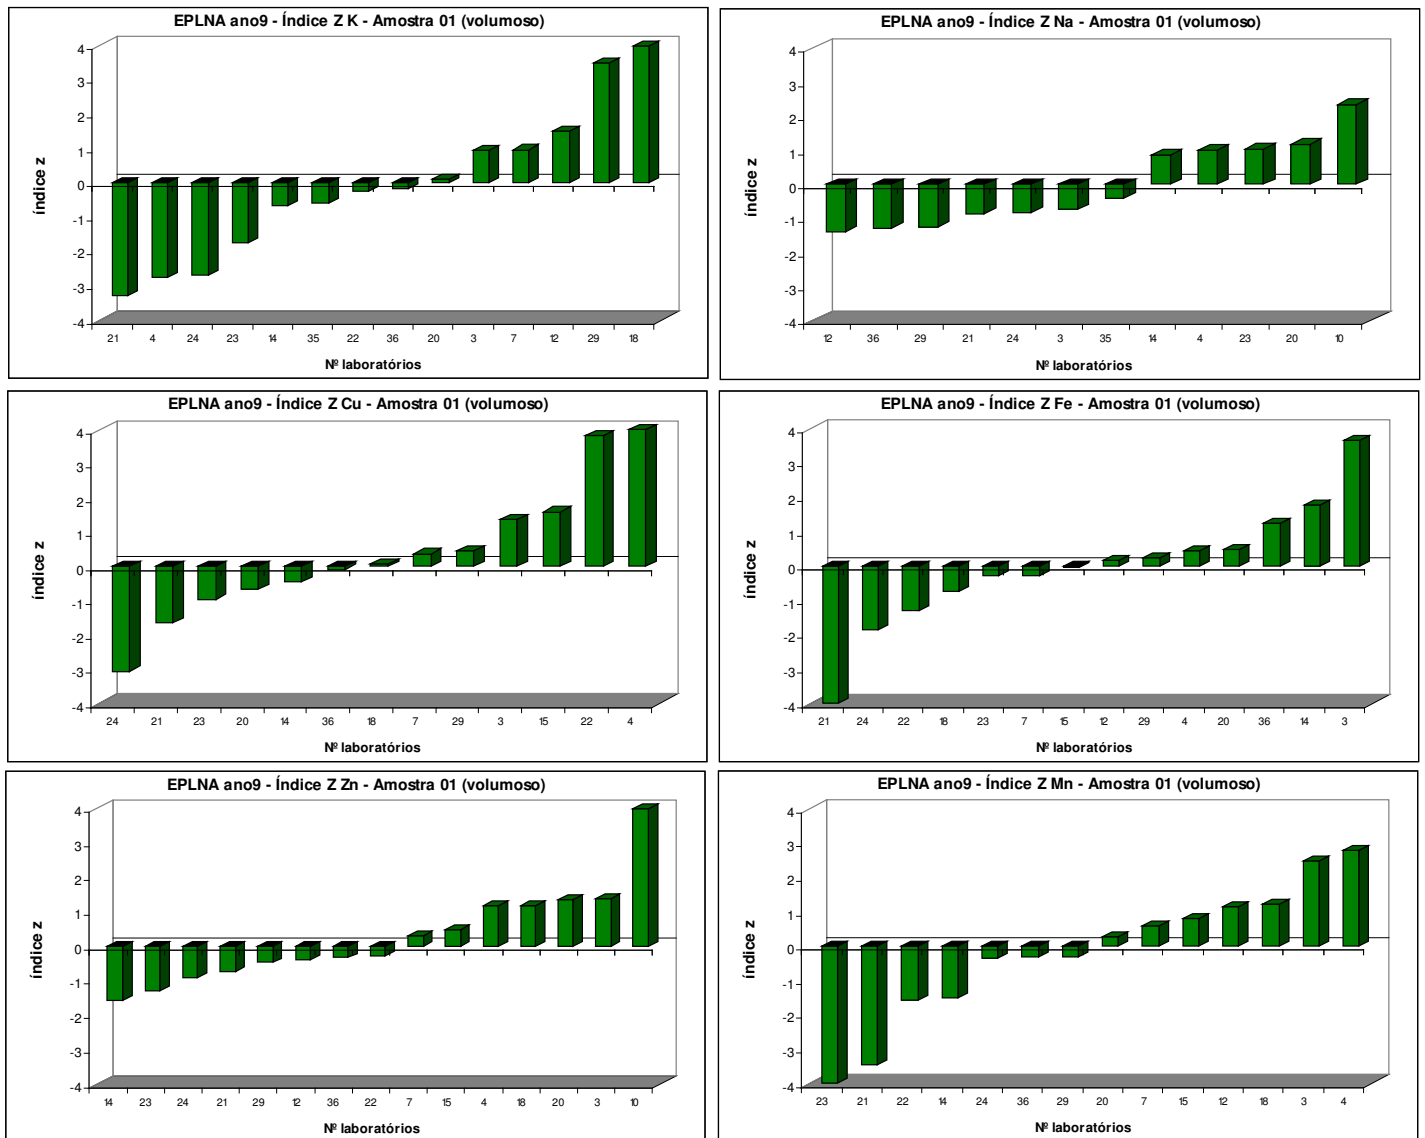









EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 03 (concentrado)

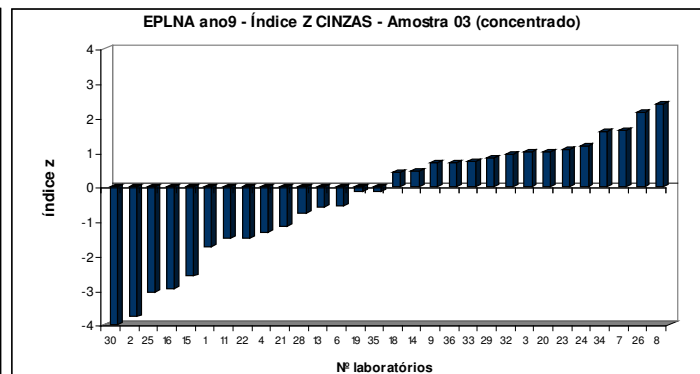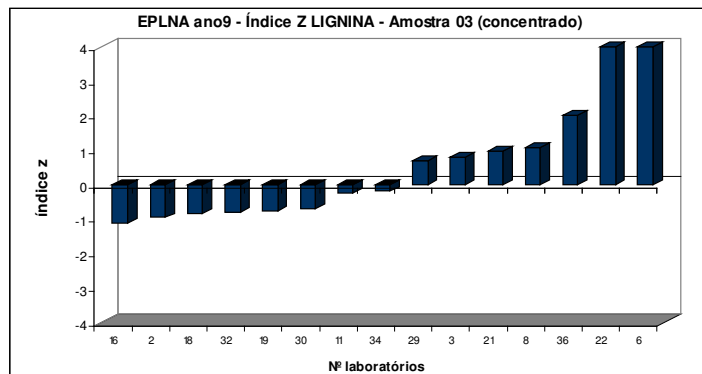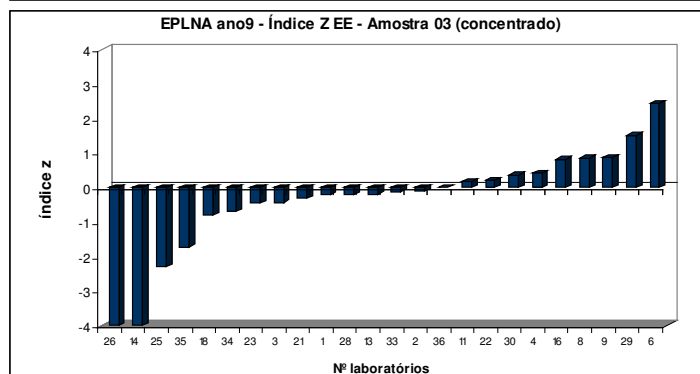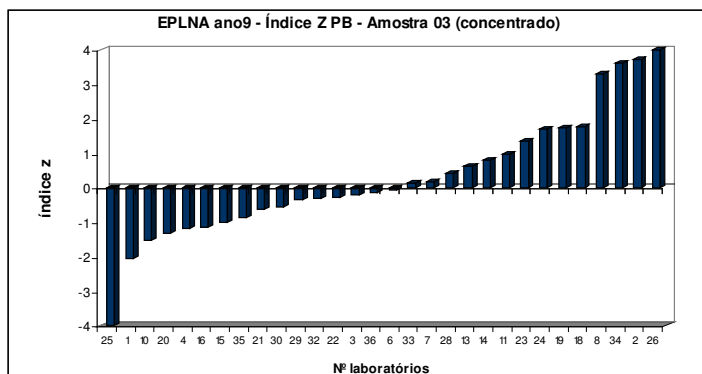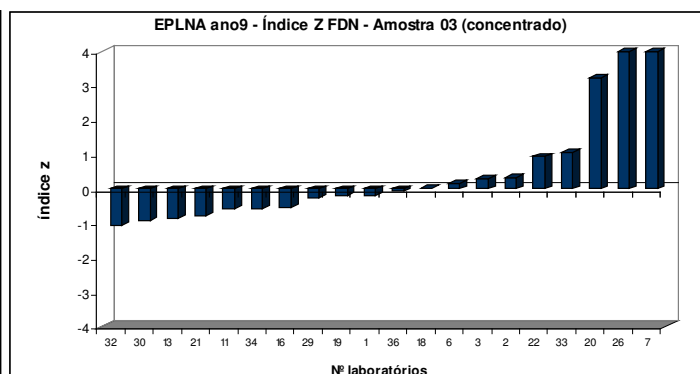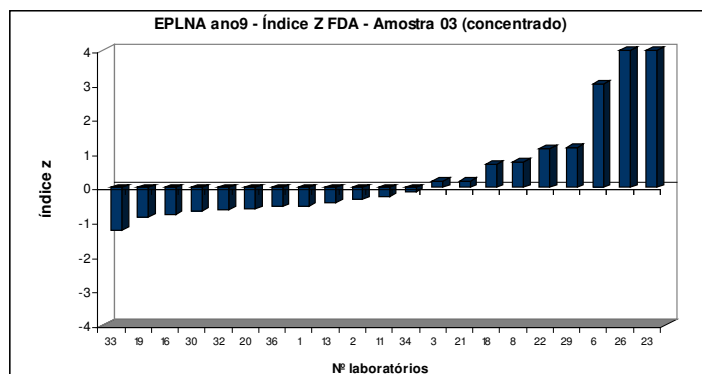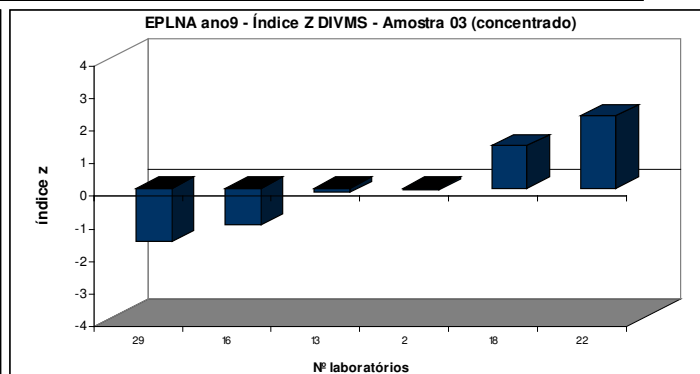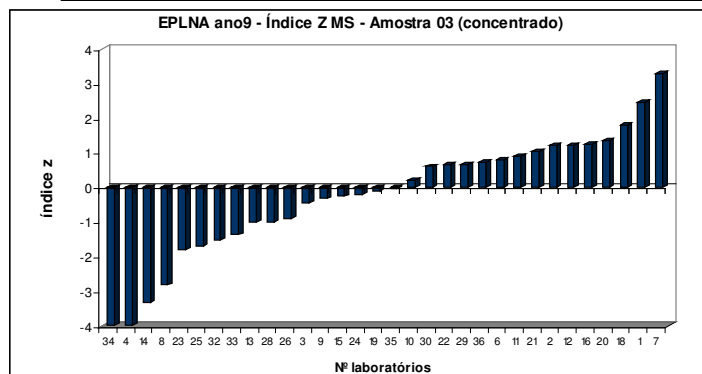







EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 03 (concentrado)

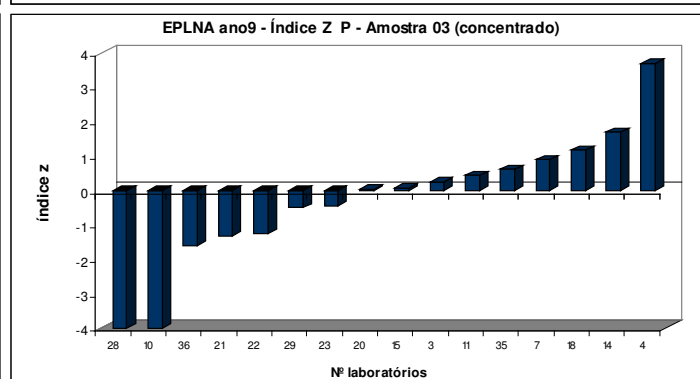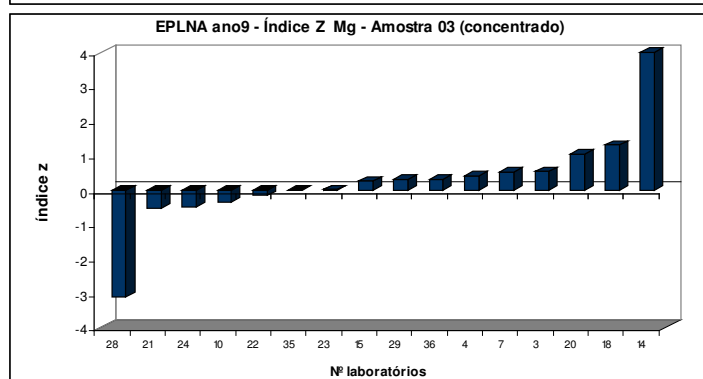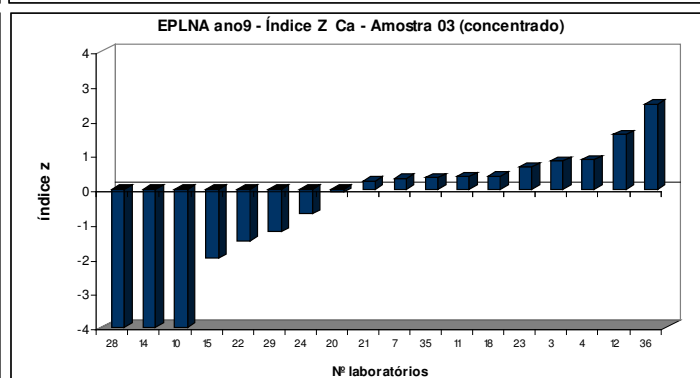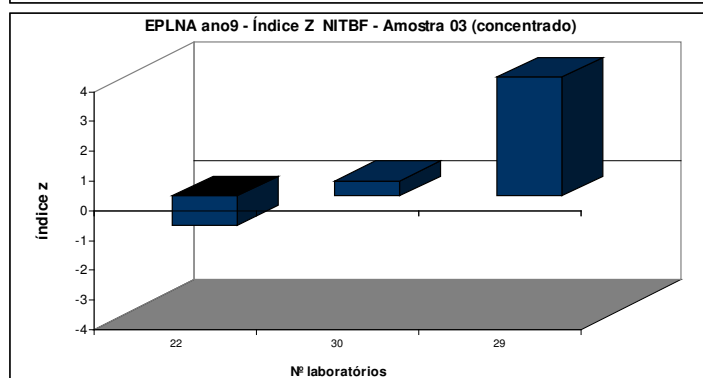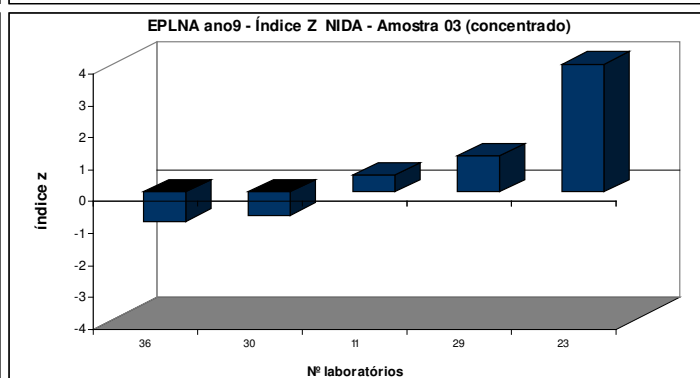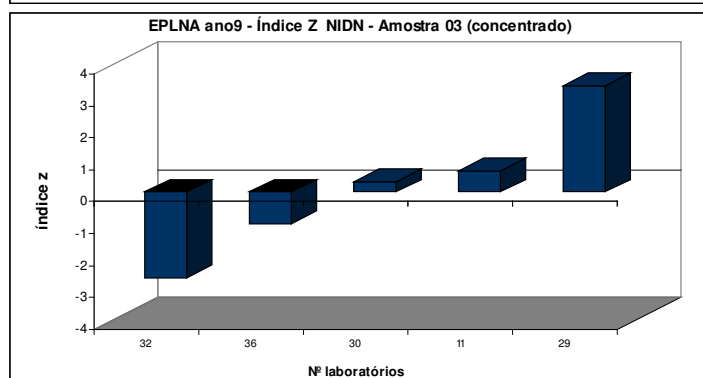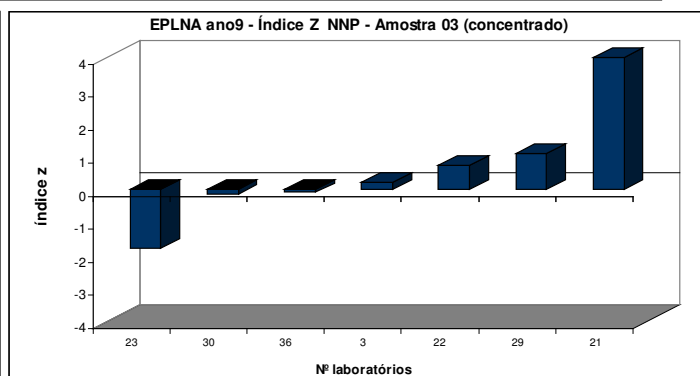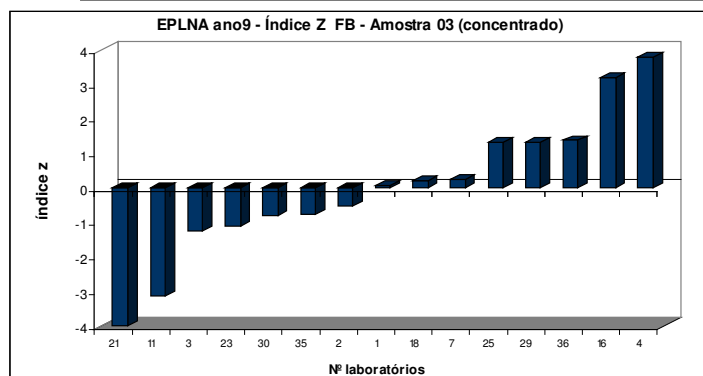







EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 03 (concentrado)

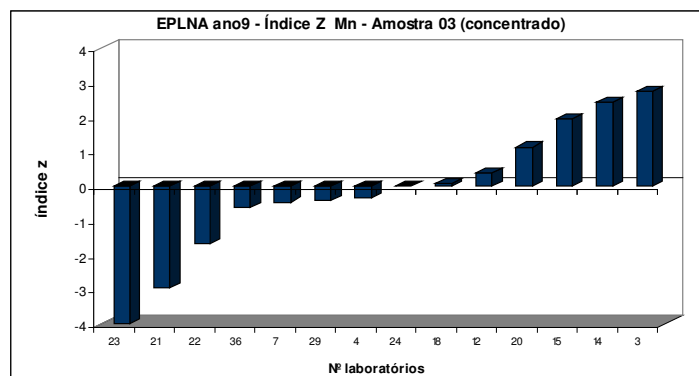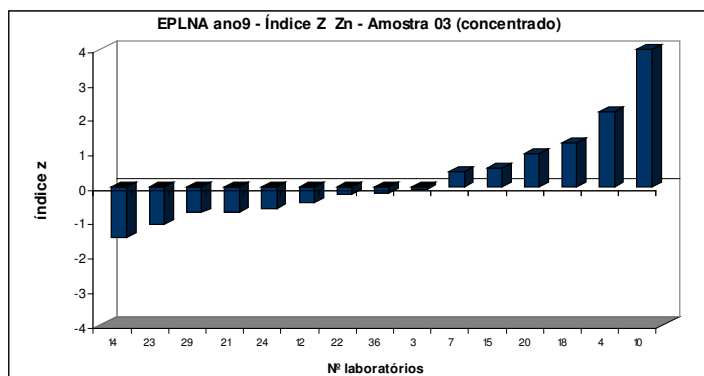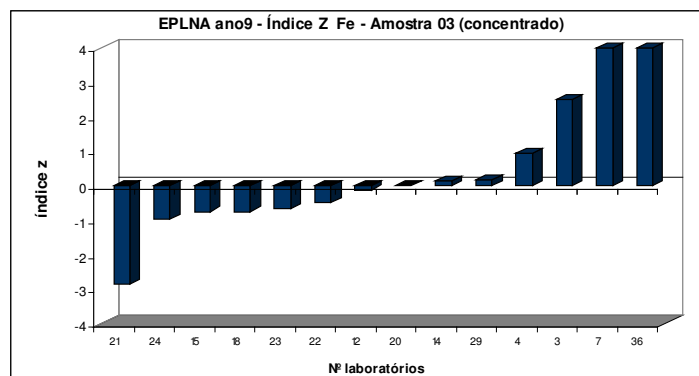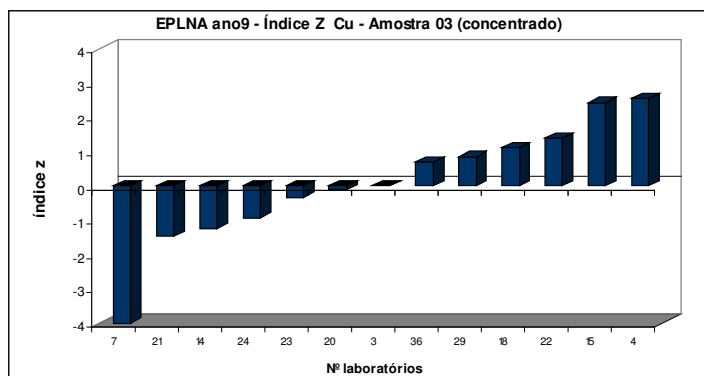
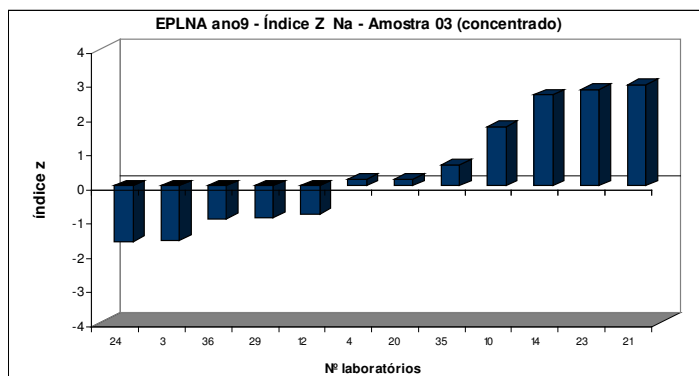
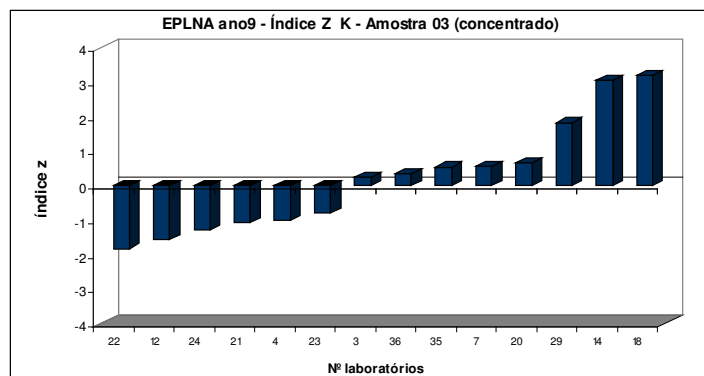


EPLNA ANO 9 (2006)

Gráficos do Índice z - Amostra 05 (mistura mineral)

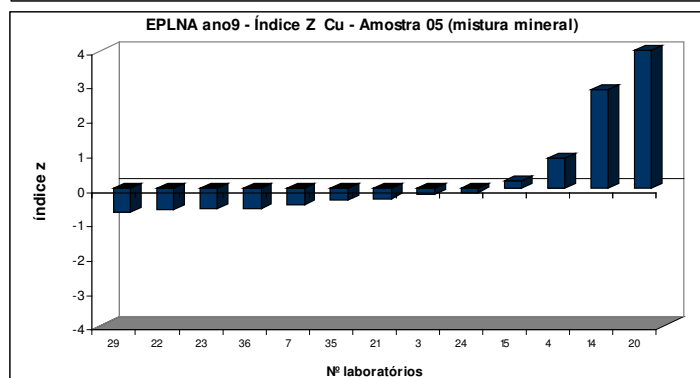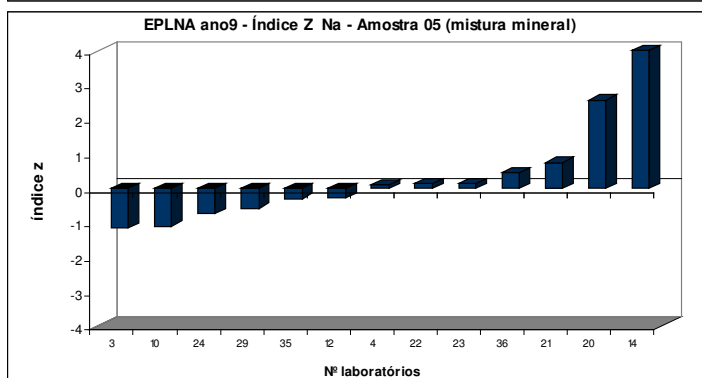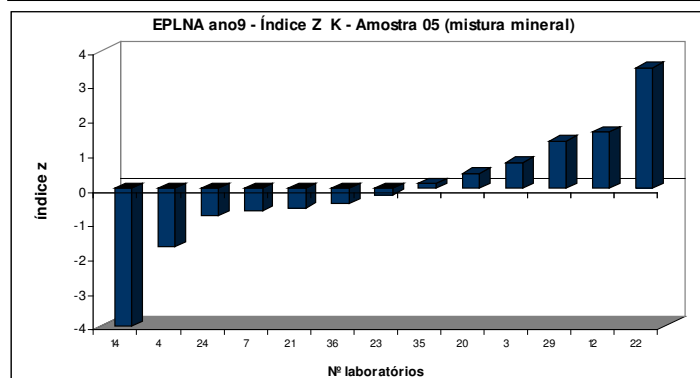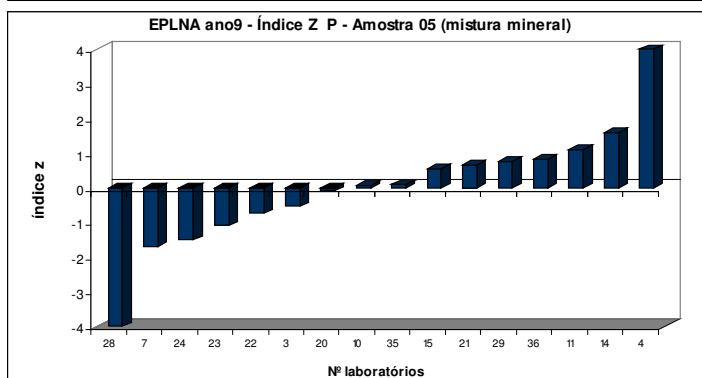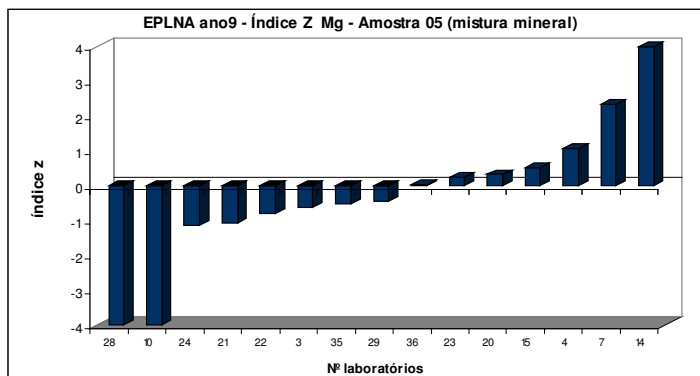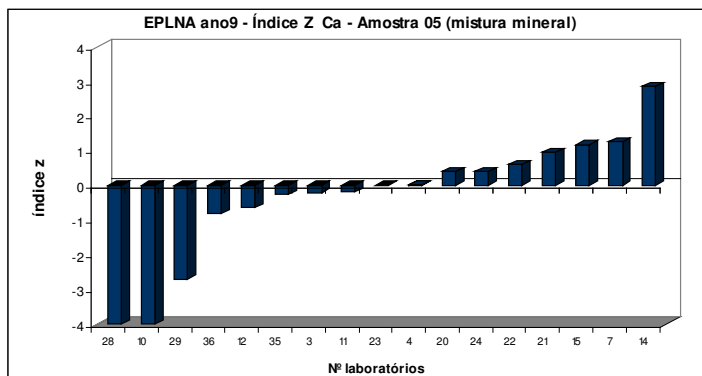


EPLNA ANO 9 (2006)
Gráficos do Índice z - Amostra 05 (mistura mineral)

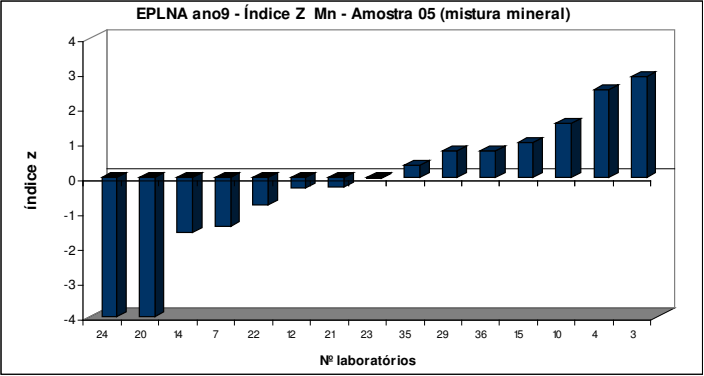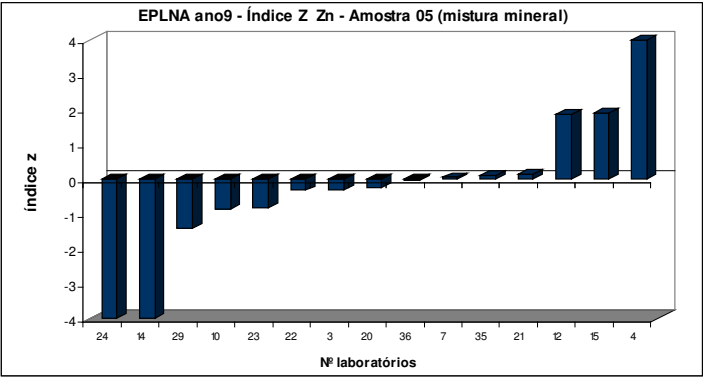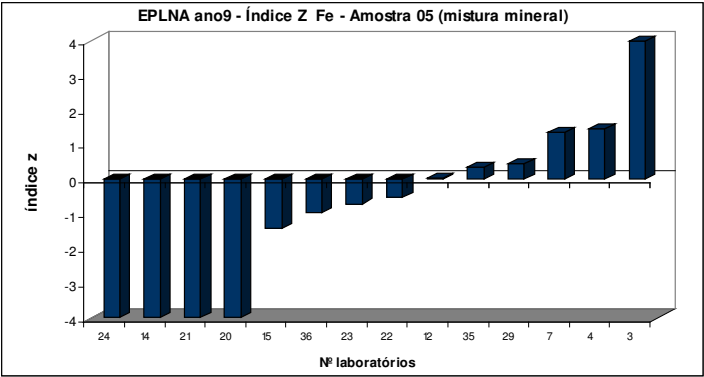


ANEXO D: Tabelas com resumo do desempenho dos laboratórios para as amostras 9/01, 9/03 e 9/05.

EPLNA ANO 9 - ÍNDICE DE ACERTO - AMOSTRA 01							
LAB	ENSAIOS (N)	Σ^*	IA	A1	A2	MP	IA_FINAL
1	7	3	57	0	3	2,0	55
2	9	1	88	0	1	0,7	88
3	18	5	72	2	3	2,7	70
4	14	4	71	3	1	1,7	70
5	-	-	-	-	-	-	-
6	7	3	57	1	2	1,7	56
7	13	0	100	0	0	0,0	100
8	7	1	85	0	1	0,7	85
9	3	0	100	0	0	0,0	100
10	7	3	57	1	2	1,7	56
11	12	1	91	0	1	0,7	91
12	7	0	100	0	0	0,0	100
13	7	0	100	0	0	0,0	100
14	13	1	92	0	1	0,7	92
15	10	1	90	1	0	0,3	90
16	11	3	72	0	3	2,0	70
17	-	-	-	-	-	-	-
18	17	3	82	1	2	1,7	81
19	6	0	100	0	0	0,0	100
20	15	3	80	3	0	1,0	79
21	18	6	66	3	3	3,0	63
22	20	2	90	1	1	1,0	89
23	17	5	70	2	3	2,7	68
24	15	2	86	1	1	1,0	85
25	7	1	85	1	0	0,3	85
26	6	4	33	1	3	2,3	31
27	-	-	-	-	-	-	-
28	8	4	50	0	4	2,7	48
29	22	3	86	1	2	1,7	85
30	12	3	75	0	3	2,0	73
31	-	-	-	-	-	-	-
32	7	0	100	0	0	0,0	100
33	6	1	83	1	0	0,3	83
34	7	2	71	1	1	1,0	70
35	9	0	100	0	0	0,0	100
36	20	1	95	1	0	0,3	95
37	-	-	-	-	-	-	-

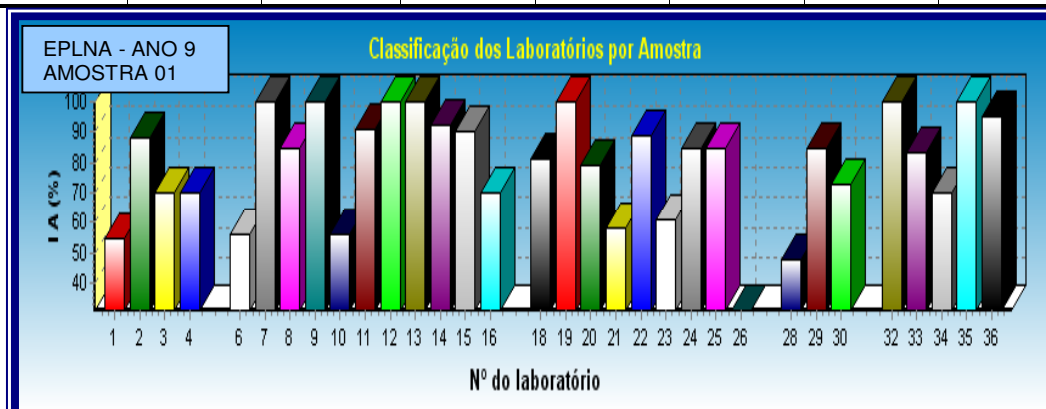

N: nº de ensaios enviados; **Σ^*** : quantidade de asteriscos recebidos; **A1:** quantidade de resultados com um asterisco; **A2:** quantidade de resultados com dois asteriscos; **MP:** média ponderada (considerou-se peso dois para **A2**); **IA:** porcentagem de resultados satisfatórios.

EPLNA ANO 9 - ÍNDICE DE ACERTO - AMOSTRA 03							
LAB	ENSAIOS (N)	Σ^*	IA	A1	A2	MP	IA_FINAL
1	7	2	71	2	0	0,7	71
2	9	2	77	0	2	1,3	76
3	18	2	88	2	0	0,7	88
4	14	5	64	2	3	2,7	62
5	-	-	-	-	-	-	-
6	7	3	57	1	2	1,7	56
7	13	4	69	0	4	2,7	67
8	6	3	50	2	1	1,3	49
9	3	0	100	0	0	0,0	100
10	7	3	57	0	3	2,0	55
11	12	1	91	0	1	0,7	91
12	7	0	100	0	0	0,0	100
13	7	0	100	0	0	0,0	100
14	13	7	46	2	5	4,0	42
15	10	2	80	2	0	0,7	80
16	9	2	77	1	1	1,0	76
17	-	-	-	-	-	-	-
18	17	1	94	0	1	0,7	94
19	6	0	100	0	0	0,0	100
20	14	1	92	0	1	0,7	92
21	18	5	72	3	2	2,3	70
22	18	2	88	1	1	1,0	87
23	17	4	76	1	3	2,3	74
24	11	0	100	0	0	0,0	100
25	5	3	40	1	2	1,7	39
26	6	5	16	1	4	3,0	13
27	-	-	-	-	-	-	-
28	7	3	57	0	3	2,0	55
29	22	2	90	0	2	1,3	89
30	12	1	91	0	1	0,7	91
31	-	-	-	-	-	-	-
32	7	1	85	1	0	0,3	85
33	6	0	100	0	0	0,0	100
34	7	2	71	0	2	1,3	70
35	10	0	100	0	0	0,0	100
36	20	3	85	2	1	1,3	84
37	-	-	-	-	-	-	-

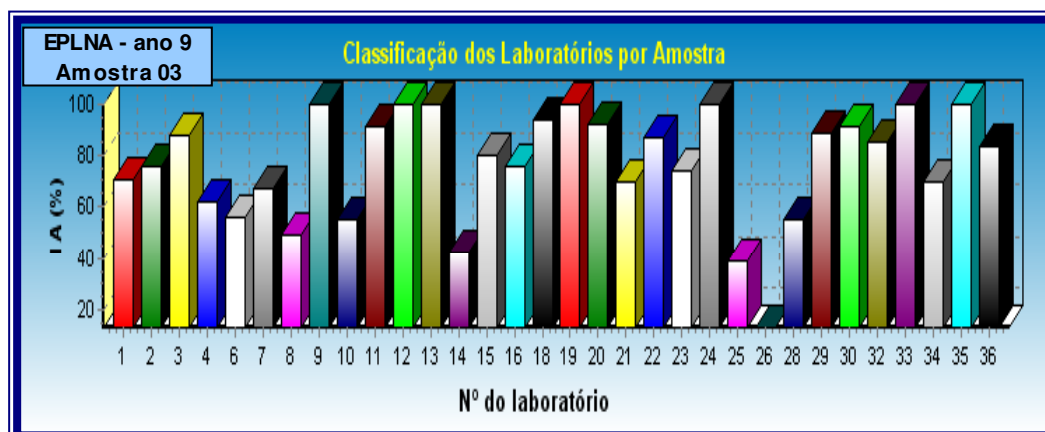

EPLNA ANO 9 - ÍNDICE DE ACERTO - AMOSTRA 05							
LAB	ENSAIOS (N)	Σ^*	IA	A1	A2	MP	IA_FINAL
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	9	2	77	1	1	1,0	76
4	9	3	66	1	2	1,7	65
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	8	1	87	1	0	0,3	87
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	6	2	66	0	2	1,3	65
11	2	0	100	0	0	0,0	100
12	6	0	100	0	0	0,0	100
13	-	-	-	-	-	-	-
14	9	7	22	2	5	4,0	18
15	7	0	100	0	0	0,0	100
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	9	4	55	1	3	2,3	53
21	9	1	88	0	1	0,7	88
22	9	1	88	0	1	0,7	88
23	9	0	100	0	0	0,0	100
24	9	3	66	0	3	2,0	64
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	3	3	0	0	3	2,0	0
29	9	1	88	1	0	0,3	88
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-
35	9	0	100	0	0	0,0	100
36	9	0	100	0	0	0,0	100
37	-	-	-	-	-	-	-

